

BORRELIA IgG ELISA RECOMBINANT ANTIGEN

ENZYME IMMUNOASSAY FOR THE QUALITATIVE OR QUANTITATIVE DETERMINATION OF IgG-
ANTIBODIES TO BORRELIA IN PLASMA, SERUM OR CEREBROSPINAL FLUID
CAT. NO. BI-21032 12 X 8 TESTS

ENZYMIMMUNOASSAY ZUR QUALITATIVEN ODER QUANTITATIVEN BESTIMMUNG VON IgG -
ANTIKÖRPERN GEGEN BORRELIEN IN PLASMA, SERUM ODER LIQUOR
KAT. NR. BI-21032 12 X 8 TESTS

IMUNOENZYMATICKÉ KVALITATIVNÍ NEBO KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG PROTI
BORRELII V PLASMĚ, SÉRU NEBO V MOZKOMÍŠNÍM MOKU.
KAT. Č. BI-21032 12 X 8 TESTŮ

IMUNOENZYMATICKÉ KVALITATÍVNE ALEBO KVANTITATÍVNE STANOVENIE IgG -PROTILÁTOK
PROTI BORÉLII V PLAZME, SÉRE ALEBO LIKVORE.
CAT. NO: BI-21032 12 X 8 VYŠETRENÍ

TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO JAKOŚCIOWEGO LUB ILOŚCIOWEGO OZNACZANIA
PRZECIWIAŁ KLASY IgG PRZECIWKO BORELII W OSOCZU, SUROWICY LUB PŁYNIE MÓZGOWO-
RDZENIOWYM
NR KAT. BI-21032 12 X 8 TESTÓW

ENZIM IMMUNOASSAY A BORRELIA ELLENI IgG ANTITESTEK KVALITATÍV VAGY KVANTITATÍV
MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSÁRA SZÉRUMBól VAGY CEREBROSPINALIS
FOLYADÉKBÓL
CAT. NO. BI-21032 12 X 8 TESZT

rev.no. 2302020 (replacing 1901110)

Biomedica Medizinprodukte GmbH, A-1210 Wien, Divischgasse 4
Tel. +43/1/291 07 45, Fax +43/1/291 07 6389, E-mail info@bmgrp.com



CONTENT / INHALT / OBSAH / OBSAH / SPIS TREŚCI / TARTALOM

- 1) ENGLISH 3**
- 2) DEUTSCH 7**
- 3) ČESKY 11**
- 4) SLOVENSKY..... 15**
- 5) POLSKI 19**
- 6) MAGYAR 23**

Additional Information about our products is available on our website.

Zusätzliche Information zu unseren Produkten ist auf unserer Homepage erhältlich.

Další informace o našem sortimentu jsou na stránkách..

Doplňujúce informácie o našich výrobkoch môžete získať na našej internetovej stránke.

Dodatkowe informacje o naszych produktach są dostępne na naszej stronie internetowej.

További információ termékeinkről internetes oldalunkon található.

www.bmgrp.com

1) INTRODUCTION

Lyme borreliosis is a bacterial infection caused by the spirochaete *Borrelia burgdorferi*, *afzelii* or *garinii*, and is characterised by a variety of clinical symptoms. It can be divided into 3 stages:

Stage 1, early dermatitis, Clinical: erythema migrans.

Stage 2, early disseminated infection, Clinical: lymphocytic meningoradiculitis (Bannwarth's syndrome), neuroborreliosis.

Stage 3, late disseminated infection, Clinical: chronic progressive encephalomyelitis, acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), chronic arthritis.

To improve the diagnostic specificity, the Biomedica microwell strips are coated with the following recombinant antigens:

- p21 = OspC (outer surface protein C): *B. burgdorferi* sensu stricto (B31), *B. garinii* (20047)
- p18: *B. afzelii* (pKo)
- p100: *B. afzelii* (pKo)
- VlsE: fusion protein of different *Borrelia* genospecies

2) CONTENTS OF THE KIT

All reagents except the wash buffer are ready for use. Store all reagents at 2-8°C.

CONT	KIT COMPONENTS	QUANTITY
PLATE	Microwell strips, breakable, colour coded, coated with recombinant antigen	12 x 8 strips
STD	Standards: positive (pos), cut-off (c.o.), negative (neg), ready to use	Each 1 x 1.5 ml
CONJ	Conjugate: rabbit anti human IgG-HRPO, ready to use	1 x 14 ml
DIL	Sample diluent with yellow dye, ready to use	1 x 105 ml
SUB	Substrate: TMB substrate solution, ready to use	1 x 13 ml
WASHBUF	Wash buffer: 20x concentrated	1 x 50 ml
STOP	Stop solution: sulphuric acid, ready to use	1 x 10 ml

3) ADDITIONAL MATERIAL ADDED TO THE KIT

- 2 self-adhesive plastic films
- Quality control sheet
- Protocol sheet
- Instruction manual for use

4) EQUIPMENT REQUIRED BUT NOT SUPPLIED

- Precision pipettes calibrated to deliver 10-1000 µl and disposable tips
- Multichannel pipette
- ELISA reader for absorbance at 450 nm (or from 450 nm to 630 nm)
- Graph paper or software for calculation of results
- Plate washer is recommended for washing

5) REAGENTS AND SAMPLE PREPARATION

Sample preparation:

The sample can be serum or plasma (EDTA, citrate, heparin, CPD), which must be separated as soon as possible from the blood clot after blood sampling to avoid a haemolysis. CSF can also be used. Avoid microbial contamination of the samples. Insoluble substances must be removed from the sample before incubation. The use of heat-inactivated, icteric, haemolytic, lipemic or turbid samples is not recommended.

If the tests are not carried out immediately, the samples can be stored for up to 2 weeks at 2-8°C. Prolonged storage of the samples is possible at -25°C or below. Repeated freezing and thawing of samples is not recommended due to the risk of inaccurate results. Avoid more than 3 freeze-thaw cycles.

Sample dilution:

Dilute human serum or plasma 1 + 100 with sample diluent (e.g. 10 µl of sample + 1 ml of sample diluent), mix well. Dilute cerebrospinal fluid 1:3 (1 + 2) with sample diluent (e.g. 100 µl of sample + 200 µl of sample diluent), mix well.


Samples with results >30 BBU/ml can be diluted with sample diluent and retested. Obtained results need to be multiplied with respective dilution factor for final concentration.

Conjugate: The conjugate is ready for use and should be used within 2 weeks after opening. For long term storage please aliquot and freeze unused conjugate at -25°C. Frozen aliquots are stable until expiry date stated on the original vial.

Preparation WASHBUF (Wash buffer): Dilute 20x conc. wash buffer with distilled water to 1000 ml (50 ml conc. + 950 ml dist. water). Mix well. Crystals that may appear will dissolve at room temperature. Undiluted WASHBUF is stable 2-8°C until expiry date stated on the label. The diluted wash buffer is stable at 2-8°C for one month.

STD: Standards (pos, cut-off, neg) are ready to use and MUST NOT be diluted.

6) PRINCIPLE OF THE ASSAY

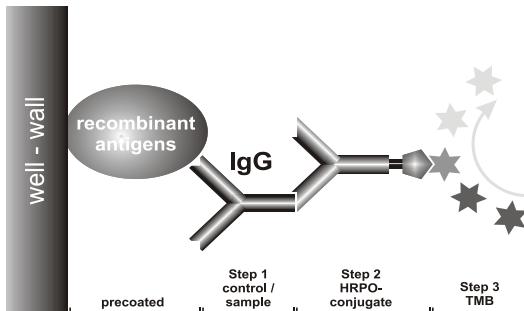

7) ASSAY PROTOCOL

All reagents and samples must be at room temperature (18-26°C) before use in the assay.

Mark position for BLANK/STD/SAMPLE/ (Blank/Standard/Sample) on the protocol sheet.

Take microtiter strips out of the alu bag, take a minimum of one well as Blank. Store unused strips with desiccant at 2-8°C in the alu bag. Strips are stable until expiry date stated on the label.

1. Add 100 µl STD/SAMPLE (Standard/diluted samples) into the respective wells, except blank.
2. Cover strips with plastic film and incubate for 1 hour at 37°C in an incubator.
3. Aspirate and wash wells 4x with at least 250 µl diluted WASHBUF (Wash buffer). Remove remaining WASHBUF by hitting plate against paper towel after the latest wash.
4. Add 100 µl CONJ (anti human IgG-HRPO) into each well.
5. Cover strips with plastic film and incubate for 30 min at room temperature (18-26°C).
6. Aspirate and wash wells 4x with at least 250 µl diluted WASHBUF (Wash buffer). Remove remaining WASHBUF by hitting plate against paper towel after the latest wash.
7. Add 100 µl SUB (TMB substrate) into each well.
8. Incubate 15 min at room temperature (18-26°C), in the dark.
9. Add 50 µl STOP (Stop solution) into each well. Swirl gently.
10. Measure absorbance immediately at 450 nm with reference 630 nm, if available.

The use of an automated system is possible, but needs sometimes modifications. If you need support, please contact your representative.

8) CALCULATION OF RESULTS

Subtract the OD of the blank from the OD's of the samples and standards.

Calculate the mean OD's of all samples and standards.

The OD of the cut-off standard represents 10 BBU/ml (Biomedica Borrelia Units). This is the basis for calculation of the results.

$$\frac{\text{OD of the sample}}{\text{OD of the cut off control}} \times 10 = \text{BBU / ml}$$

The quality control protocol supplied with the kit shows the results of the final release QC for each kit. Data for optical density obtained by customers may differ due to various influences and/or due to the normal decrease of signal intensity during shelf life. However, this does not affect validity of results as long as data mentioned in chapter 9) ASSAY CHARACTERISTICS part valid results are achieved.

8.1. Qualitative calculation for serum/plasma

Positive result	samples with an OD of more than cut-off +10% (≥ 11 BBU/ml).
Borderline result	samples between 9 - 11 BBU/ml. These patients should be retested with a new sample.
Negative result	samples with an OD of less than cut-off -10% (≤ 9 BBU/ml).

8.2. Quantitative calculation for serum/plasma

Calculation of the BBU/ml is identical to the qualitative calculation, section 8.1.

The test is linear between 5 - 30 BBU/ml. Values outside this range are semi-quantitative.

Alternatively, samples with results >30 BBU/ml can be diluted with sample diluent and retested. Obtained results need to be multiplied with respective dilution factor for final concentration.

Weak positive	Samples between 11 - 20 BBU/ml
High positive	Samples between 21 - 30 BBU/ml
Very high positive	Samples above 30 BBU/ml

8.3. Qualitative calculation for cerebrospinal fluid

The calculation of the BBU/ml is identical to the qualitative calculation, section 8.1.

Normal values CSF: The mean of 30 CSF samples showed 0.9 BBU/ml.

Neuroborreliosis negative	Samples with values ≤ 5 BBU/ml
Suspected for Neuroborreliosis	Samples with values > 5 BBU/ml

9) ASSAY CHARACTERISTICS

Valid results:

Blank	The OD must be ≤ 0.250
Negative standard	The OD must be ≤ 0.200 (blank subtracted)
Cut-off standard	The OD must be at least twice the negative standard (blank subtracted).
Positive standard	The OD must be at least twice the OD of the cut-off standard (blank subtracted).

Crossreactivities

	n	crossreactive
rheumafactor-positive	15	0
syphilis-positive	7	0

This ELISA uses recombinant antigens. Nevertheless, crossreactions to autoimmune-positive samples cannot be completely excluded.

Specificity & Sensitivity:

	Serum	CSF
Sensitivity	100%	88%
Specificity	96%	88%

10) PRECISION

Intra-assay	pos. (n=8)	high pos. (n=8)	Inter-assay	pos. (n=12)	high pos. (n=12)
Mean (BBU/ml)	29	43	Mean (BBU/ml)	29	46
SD (BBU/ml)	2	4	SD (BBU/ml)	2	3
CV (%)	7.6	9.1	CV (%)	6.8	6.6

11) TECHNICAL HINTS

- Do not mix or substitute reagents with those from other lots or sources.
- Avoid foaming when mixing reagents.
- Do not mix stoppers and caps from different reagents or use reagents between lots.
- Do not use reagents beyond expiration date. Protect reagents from direct sunlight.
- Substrate solution should remain colourless until added to the plate.

12) PRECAUTIONS

All test components of human source were tested against HIV-Ab, HCV-Ab and HBsAg and were found negative. Nevertheless, they should be handled and disposed as if they were infectious. Liquid reagents contain ≤0.1% Proclin 950 as preservative. Proclin 950 is not toxic in concentrations used in this kit. It may cause allergic skin reactions, avoid contact with skin or eyes.

- Do not pipette by mouth.
- Do not eat, drink, smoke or apply cosmetics where reagents are used.
- Avoid all contact with the reagents by using gloves.
- Sulfuric acid is irritating to eyes and skin. Flush with water if contact occurs. Avoid contact with skin and mucous. Irritations are possible. – Flush with water after contact!

13) LITERATURE

- "Use of Recombinant Antigens of *Borrelia Burgdorferi* in Serologic Tests for Diagnosis of Lyme Borreliosis", MAGNAREELI L.A. et al. (1996), Journal of Clin. Microbiol. 34: 2 pp 237-240
- "Immunological and Molecular Heterogeneity of the Outer Surface Protein C (OspC) of *Borrelia Burgdorferi* Sensu Lato", HEIPKE S.J et al., pp 11-14
- "Identification of a Protein in Several *Borrelia* Species Which Is Related to OspC of the Lyme Disease Spirochetes", MARKONI R.T. et al. (1993), Journal of Clin Microbiol., pp 2577-2583
- "Antigenic Variation and Variation in Expression of Immunodominant *B. Burgdorferi* Antigens: Implications for using Recombinant Antigens for Serodiagnosis", WILSKE B. et al., pp 179-182
- Review. "Diagnosis of Lyme Borreliosis in Europe Vector-borne and Zoonotic Disease.3", No. 4, 215 -227 (2003), Wilske B.
- "Characterisation of the vls antigenic variation loci of the Lyme disease spirochaetes *Borrelia garinii* Ip90 and *Borrelia afzelii* ACA1" (2003). Eicken C. et al. Mol. Microbiol. 47 (5), 1407-1417

1) EINLEITUNG

Die Bakterien *Borrelia burgdorferi*, *afzelii* und *garinii* sind die Erreger der am häufigsten durch Zecken übertragenen Infektionskrankheit Lyme-Borreliose. Die Infektion mit *Borrelia* ist durch eine Anzahl von klinischen Symptomen charakterisiert und wird in 3 Stadien unterteilt.

Stadium 1, als früh lokalisierte Hautrötung. Klinisch: Erythema migrans (Wanderröte).

Stadium 2, als früh disseminierende Erkrankung. Klinisch: lymphocytäre Meningoradikulitis (Bannwarth-Syndrom), Neuroborreliose.

Stadium 3, als späte disseminierende Erkrankung. Klinisch: chronisch progressive Enzephalomyelitis, Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), chronische Arthritis.

Um die Spezifität der Diagnostik zu erhöhen, wurden die Mikrotiterstrips des vorliegenden ELISA mit folgenden rekombinanten Antigenen beschichtet:

- p21 = OspC (outer surface protein C): *B. burgdorferi* sensu stricto (B31), *B. garinii* (20047)
- p18: *B. afzelii* (pKo)
- p100: *B. afzelii* (pKo)
- VlsE: Fusionsprotein von unterschiedlichen *Borrelia* Genospezies

2) INHALT DES KITS

Alle Reagenzien mit Ausnahme des Waschpufferkonzentrats sind gebrauchsfertig. Lagerung aller Reagenzien bei 2-8°C.

CONT	KIT KOMPONENTEN	MENGE
PLATE	Mikrotiterplattenstreifen beschichtet mit rekombinanten Antigenen, einzeln brechbar, farbkodiert	12 x 8 Teste
STD	Standards: Positiv (pos), Cut-off (c.o.), Negativ (neg), gebrauchsfertig	je 1 x 1,5 ml
CONJ	Konjugat: Kaninchen anti human IgG-HRPO, gebrauchsfertig	1 x 14 ml
DIL	Verdünnungspuffer, gelb gefärbt, gebrauchsfertig	1 x 105 ml
SUB	Substrat: TMB Substratlösung, gebrauchsfertig	1 x 13 ml
WASHBUF	Waschpuffer: 20x konzentriert	1 x 50 ml
STOP	Stoplösung: Schwefelsäure, gebrauchsfertig	1 x 10 ml

3) ZUSÄTZLICHES MATERIAL IM KIT

- 2 selbstklebende Abdeckfolien
- Qualitätskontrollblatt
- Protokoll Blatt
- Arbeitsanleitung (Beipacktext)

4) ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES MATERIAL UND GERÄTE

- Kalibrierte Präzisionspipetten für 10-1000 µl, inkl. Pipettenspitzen
- Mehrkanalpipette
- Mikrotiterplattenphotometer mit 450 nm Filter (630 nm Referenz)
- Halblogarithmisches Millimeterpapier oder Software
- Mikrotiterplatten Wascher wird empfohlen

5) REAGENZIEN UND PROBENVORBEREITUNG

Probenvorbereitung:

Abnahme von venösem Blut mittels standardisierter Blutabnahmeröhrchen zur Gewinnung von Serum oder Plasma (EDTA, Citrat, Heparin, CPD). Durchführung der Zentrifugation des Blutes laut Herstellerangaben der Probenentnahmehälter, so schnell wie möglich, um Hämolyse zu vermeiden. Liquor kann auch verwendet werden.

Vermeiden Sie mikrobielle Kontamination der Proben. Unlösliche Teile müssen vor Inkubation aus der Probe entfernt werden. Hitze-inaktivierte, ikterische, hämolytische, lipemische oder trübe Proben können nicht verwendet werden.

Proben so schnell wie möglich messen oder sie können bis zu 2 Wochen bei 4°C gelagert werden. Für Langzeit Lagerung die Proben aliquotiert und bei -25°C oder tiefer lagern. Bis zu 3 Frier/Tau-Zyklen verändern die Messwerte nicht.

Verdünnen der Patientenproben:

Serum oder Plasma: 1 + 100 mit Verdünnungspuffer verdünnen und gut mischen (z.B. 10 µl Patientenprobe + 1 ml Verdünnungspuffer).

Zerebrospinalflüssigkeit 1:3 (1 + 2) mit Verdünnungspuffer verdünnen und gut mischen (z.B. 100 µl

Zerebrospinalflüssigkeit + 200 µl Verdünnungspuffer).

Proben mit Werten >30 BBU/ml können mit Verdünnungspuffer verdünnt und nochmals getestet werden. Zur Berechnung des Endergebnisses müssen die erhaltenen Werte mit dem Verdünnungsfaktor multipliziert werden.

Konjugat. Nach dem Öffnen das Konjugat innerhalb von 2 Wochen verwenden. Für längere Lagerung (bis zum Ablaufdatum) soll nicht verwendetes Konjugat aliquotiert und bei -25°C gelagert werden.

Verdünnen des WASHBUF (Waschpuffers):

20fach Waschpufferkonzentrat auf 1000 ml mit destilliertem Wasser verdünnen (50 ml Konzentrat + 950 ml dest. Wasser). Gut mischen. Kristalle lösen sich bei Raumtemperatur auf. Unverdünnter Waschpuffer ist bei 2-8°C bis zum Ablaufdatum (s. Etikett) haltbar. Der verdünnte Waschpuffer ist bei 2-8°C bis zu einem Monat haltbar. Im Testsystem darf nur verdünnter WASHBUF (Waschpuffer) verwendet werden.

STD: Die Standards (pos, cut-off, neg) sind gebrauchsfertig und dürfen nicht verdünnt werden.

6) TESTPRINZIP

Siehe 6) PRINCIPLE OF THE ASSAY im englischen Teil des Beipacktextes.

7) TESTPROTOKOLL

Im Test dürfen nur Reagenzien und Proben verwendet werden, welche Raumtemperatur (18-26°C) aufweisen.

Markieren Sie die Positionen für BLANK/STD/PROBE (Leerwert/Standard/Probe) am Protokoll Blatt.

Nehmen Sie die benötigten Mikrotiterstreifen aus dem Alu Säckchen. Mindestens 1 Well für den Leerwert reservieren.

Nicht verwendete Mikrotiterstreifen können mit Trockenmittel im Alu Säckchen bis zum angegebenen Ablaufdatum gelagert werden.

1. Pipettieren Sie 100 µl STD/SAMPLE (Standard/Verdünnte Probe) in Doppelbestimmung in die Mikrotiterstreifen, mit Ausnahme des Leerwertes.
- 2. Streifen abdecken und 1 Stunde bei 37°C inkubieren.**
3. Inhalt der Wells verwerfen und 4x mit mindestens 250 µl verdünntem WASHBUF (Waschpuffer) waschen. Nach dem letzten Waschschritt Reste von Waschpuffer durch Ausklopfen auf saugfähiges Papier entfernen.
4. Pipettieren Sie 100 µl CONJ (anti human IgG-HRPO) in alle Wells.
- 5. Streifen abdecken und 30 Minuten bei Raumtemperatur (18-26°C) inkubieren.**
6. Inhalt der Wells verwerfen und 4x mit mindestens 250 µl verdünntem WASHBUF (Waschpuffer) waschen. Nach dem letzten Waschschritt Reste von Waschpuffer durch Ausklopfen auf saugfähiges Papier entfernen.
7. Pipettieren Sie 100 µl SUB (TMB Substrat) in alle Wells.
- 8. 15 Minuten bei Raumtemperatur (18-26°C) im Dunkeln inkubieren.**
9. Pipettieren Sie 50 µl STOP (Stopplösung) in alle Wells. Gut mischen.
10. Extinktion unmittelbar bei 450 nm messen, mit 630 nm als Referenz, falls möglich.

Die Verwendung des Testsystems auf automatischen Systemen ist möglich, kann aber Modifikationen benötigen. Für eventuelle Hilfestellung wenden Sie sich bitte an die lokale Vertretung.

8) BERECHNUNG DER ERGEBNISSE

Die Extinktion des Leerwertes (Blank) von den Extinktionen der restlichen Bestimmungen abziehen.

Mittelwerte der Extinktionen der Kontrollen und der Proben berechnen.

Der Messwert des Cut-off Standards ist für die Beurteilung der Proben wichtig. Er entspricht 10 BBU/ml (Biomedica Borrelia Units) und ist die Basis für die Kalkulation der Ergebnisse.

$$\frac{\text{Ø OD of the sample}}{\text{Ø OD of the cut off control}} \times 10 = \text{BBU / ml}$$

8.1. Qualitative Kalkulation für Serum/Plasma

Positives Ergebnis	Proben mit einer OD größer der des Cutoff +10% ($\geq 11 \text{ BBU/ml}$)
Grenzwertiges Ergebnis	Proben zwischen 9 - 11 BBU/ml. Grenzwertige Ergebnisse sollten mit einer neuen Probenabnahme wiederholt werden.
Negatives Ergebnis	Proben mit einer OD kleiner der des Cutoff -10% ($\leq 9 \text{ BBU/ml}$)

8.2. Quantitative Kalkulation für Serum/Plasma

Die Berechnung der BBU/ml erfolgt analog der qualitativen Auswertung, Kapitel 8.1.

Das Testsystem ist im Bereich von 5 - 30 BBU/ml linear. Werte außerhalb dieses Bereiches dürfen nur als semi-quantitativ betrachtet werden.

Alternativ können Proben mit Werten >30 BBU/ml mit Verdünnungspuffer verdünnt und nochmals getestet werden. Zur Berechnung des Endergebnisses müssen die erhaltenen Werte mit dem Verdünnungsfaktor multipliziert werden.

Schwach positiv	Proben mit Werten zwischen 11 - 20 BBU/ml
Stark positiv	Proben mit Werten zwischen 21 - 30 BBU/ml
Sehr stark positiv	Proben mit Werten größer 30 BBU/ml

8.3. Qualitative Kalkulation für Zerebrospinalflüssigkeit

Die Berechnung der BBU/ml erfolgt analog der qualitativen Auswertung, Kapitel 8.1.

Normalwerte CSF: Es wurden 30 Liquor Proben getestet und durchschnittlich 0,9 BBU/ml gefunden.

Neuroborreliose negativ	Proben mit Werten $\leq 5 \text{ BBU/ml}$
Verdacht auf Neuroborreliose	Proben mit Werten $> 5 \text{ BBU/ml}$

9) TESTMERKMALE

Gültigkeit der Bestimmung:

Leerwert	Die OD muss $\leq 0,250$ sein
Negativer Standard	Die OD muss $\leq 0,200$ sein (Leerwert abgezogen)
Cut-off Standard	Die OD muss mindestens 2x so hoch wie der negative Standard sein (Leerwert abgezogen)
Positiver Standard	Die OD muss mindestens 2x so hoch wie der Cut off Standard sein (Leerwert abgezogen)

Kreuzreaktionen

	n	Reaktiv
Rheumafaktor positive Proben	15	0
Syphilis positive Proben	7	0

Trotz Verwendung von rekombinanten Antigenen kann eine Kreuzreaktion zu autoimmun-positiven Proben nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Spezifität & Sensitivität:

	Serum	CSF
Sensitivität	100%	88%
Spezifität	96%	88%

10) PRÄZISION

Intra-assay	pos. (n=8)	stark pos. (n=8)	Inter-assay	pos. (n=12)	stark pos. (n=12)
Mittelwert (BBU/ml)	29	43	Mittelwert (BBU/ml)	29	46
SD (BBU/ml)	2	4	SD (BBU/ml)	2	3
VK (%)	7,6	9,1	VK (%)	6,8	6,6

11) TECHNISCHE MERKMALE

- Reagenzien von verschiedenen Lots oder Testen dürfen nicht gemischt werden.
- Stöpsel oder Verschlüsse von verschiedenen Reagenzien dürfen nicht vertauscht werden.
- Abgelaufene Reagenzien dürfen nicht verwendet werden. Reagenzien sind vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
- Substratlösung muss vor Verwendung farblos sein.

- Mikrotiterstreifen müssen bei den Inkubationen mit Abdeckfolie abgedeckt sein.
- Vermeiden Sie Schaumbildung beim Mischen der Reagenzien.

12) VORSICHTSMASSNAHMEN

Alle Bestandteile humanen Ursprungs wurden auf HIV-Ak, HCV-Ak und HBsAg getestet und negativ gefunden. Trotzdem sollten die Reagenzien als potentiell infektiös behandelt werden.

Die flüssigen Reagenzien enthalten ≤ 0,1% Proclin 950 als Konservierungsmittel.

Proclin 950 ist in der verwendeten Konzentration nicht toxisch. Allergische Reaktionen sind möglich.

- Nicht mit dem Mund pipettieren.
- Nicht Rauchen, Essen, Trinken oder Kosmetika benutzen während der Verwendung der Testreagenzien.
- Verwenden Sie Handschuhe zur Vermeidung jedes Kontaktes zu Reagenzien.
- Schwefelsäure reizt die Augen und die Haut. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen.

13) LITERATUR

Siehe 13) LITERATURE im englischen Teil des Beipacktextes.

1) ÚVOD

Lymská borrelióza je bakteriální infekce vyvolaná spirochetou *Borrelia Burgdorferi*, *Afzelii* nebo *Garinii* a je charakterizována různými klinickými příznaky. Onemocnění je rozdělováno do tří stadií.

1. stadium časná dermatitida, klinicky erythema migrans.
2. stadium časná diseminovaná infekce, klinicky lymfocytická meningoradiculitida (Bannwarthův syndrom), neuroborrelióza.
3. stadium pozdní diseminovaná infekce, klinicky chronická progresivní encefalomyelitida, chronická atrofující akrodermatitida, chronická artritida.

Pro zvýšení diagnostické specifity jsou jamky destiček soupravy Biomedica potaženy téměř rekombinantními antigeny:

- p21 = OspC (outer surface protein C – vnější povrchový protein C): *B. burgdorferi sensu stricto* (B31), *B. garinii* (20047)
- p18: *B. afzelii* (pKo)
- p100: *B. afzelii* (pKo)
- VlsE: směsné proteiny jiných genotypů *Borrelia*

2) OBSAH SOUPRAVY

Všechny reagencie v soupravě vyjma promývací pufr jsou k okamžitému použití. Souprava se všemi reagenciemi se uchovává při teplotě 2-8°C.

REAGENCIE	POPIS	MNOŽSTVÍ
PLATE	Stripy s jamkami, potaženými antigenem, Oddělují se odlamováním, jsou barevně kódované.	12 x 8 stripů
STD	Standardy: pozitivní (pos), hraniční (cut-off), negativní (neg), používají se přímo	každá 1 x 1,5 ml
CONJ	konjugát králičí anti-human IgG – HRPO, používá se přímo	1 x 14 ml
DIL	roztok na ředění vzorků, používá se přímo	1 x 105 ml
SUB	roztok TMB substrátu, používá se přímo	1 x 13 ml
WASHBUF	promývací pufr 20x koncentrovaný	1 x 50 ml
STOP	stop roztok konc. kys.sírová, používá se přímo	1 x 10 ml

3) DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUPRAVY

- 2 samolepící folie
- kontrolní list kvality
- protokol provedení testu
- návod k používání soupravy

4) VYBAVENÍ POTŘEBNÉ K ROVEDENÍ TESTU (nedodává se v soupravě)

- přesné kalibrované mikropipety na objem 10 µl – 1000 µl
- vícekanálové mikropipety
- ELISA mikrofotometr s filtrem 450 nm nebo s filtry 450 nm a 630 nm
- Milimetrový papír nebo program pro výpočet výsledků
- Doporučuje se promývačka na promývání destiček

5) PŘÍPRAVA REAGENCÍ A VZORKŮ

Příprava vzorku:

Vzorkem může být sérum nebo plasma (EDTA, citrát, heparin, CPD), které musí být separovány od krevních sraženin a buněk co možná nejdříve, aby nedocházelo k hemolýze. Rovněž lze použít mozkomíšní mok. Vyvarujte se mikrobiální kontaminace vzorků. Nerozpustné látky musí být ze vzorku odstraněny před inkubací. Použití tepelně inaktivovaných, ikerických, hemolytických, lipemických nebo zakalených vzorků se nedoporučuje.

Upozornění: pokud se neprovádí testy bezprostředně, mohou se vzorky skladovat při 2-8°C po dobu až 2 týdnů. Delší skladování vzorků je možné při teplotě -25°C nebo nižší. Opakované zmrazování a tání vzorků se nedoporučuje kvůli riziku nesprávných výsledků. Vyvarujte se více než 3 cyklům zmrazení-tání.

Ředění vzorků: Lidské sérum nebo plasma se ředí 1 + 100 roztokem na ředění vzorků (10 µl vzorku a 1 ml roztoku na ředění vzorků) a dobře se promíchá.

Mozkomíšní mok se ředí 1:3 (1 + 2) roztokem na ředění vzorků (100 µl vzorku a 200 µl roztoku na ředění vzorků) a dobře se promíchá.

Vzorky s výsledky >30 BBU/ml mohou být naředěny diluentem a opakovaně testovány. Získané výsledky musí být násobeny příslušným faktorem ředění na výslednou koncentraci.

Konjugát: Konjugát k přímému použití by měl být spotřebován do dvou týdnů po otevření. Pro dlouhodobé skladování nepoužijte konjugát rozdělte na alikvoty a uložte při -25°C do data expirace.

Příprava promývacího pufu: Koncentrovaný promývací puf WASHBUF se ředí destilovanou vodou na 1000 ml (50 ml koncentrovaného pufu se přidá k 950 ml destilované nebo deionizované vody) a dobře se promíchá. Případné krystaly se rozpustí při teplotě laboratoře. Naředěný promývací puf je stálý při 2-8°C až do data expirace, které je uvedeno na štítku.

STD: Standardy (pos, cut-off, neg) jsou připraveny k použití a NESMÍ být ředěny.

6) PRINCIP STANOVENÍ

Viz. 6) PRINCIPLE OF THE ASSAY v anglické části této příbalové informace.

7) PROVEDENÍ TESTU

Všechny reagencie a vzorky musí být před prováděním testu vytemperovány na teplotu laboratoře 18-26°C.

Na protokolu provedení testu se vyznačí jamky pro slepou, kontroly a vzorky.

.Ze sáčku se vymhou stripy s jamkami, nejméně jedna jamka se použije pro slepou (blank). Nepoužité stripy se vloží zpět do sáčku s vysoušelem a uloží při teplotě 2-8°C. Stripy jsou stálé až do data expirace, které je uvedeno na sáčku.

1. Do určených jamek se napipetuje 100 µl kontrol a vzorků, jamka pro slepu se vynechá.
2. **Jamky se zakryjí samolepící fólií a inkubují se 1 hodinu v inkubátoru při teplotě 37°C.**
3. Po skončení inkubace se z jamek odsaje kapalina a jamky se promyjí 4x nejméně 250 µl naředěného promývacího pufu. Po skončeném promývání se zbytky pufu odstraní z jamek poklepáním strippem na filtrační papír.
4. Do všech jamek se napipetuje 100 µl konjugátu.
5. **Jamky se zakryjí samolepící fólií a inkubují se 30 minut při teplotě laboratoře 18-26°C.**
6. Po skončení inkubace se z jamek odsaje kapalina a jamky se promyjí 4x nejméně 250 µl naředěného promývacího pufu. Po skončeném promývání se zbytky pufu odstraní z jamek poklepáním strippem na filtrační papír.
7. Do všech jamek se napipetuje 100 µl TMB substrátu.
8. **Inkubuje se 15 minut ve tmě při teplotě laboratoře 18-26°C.**
9. Do všech jamek se napipetuje 50 µl stop roztoku.
10. Ihned se změří absorbance jamek OD při 450 nm a pokud je možné také při referenčním filtru 630 nm.

Test lze provádět v automatickém ELISA systému, ale vyžaduje některé modifikace. Pokud byste potřebovali pomoc, obraťte se na našeho zástupce.

8) VÝPOČET VÝSLEDKŮ

Od absorbance OD vzorků a kontrol se odečte OD slepé a vypočítají se průměrné hodnoty OD všech standardů a vzorků. Hodnota OD hraniční (cutoff) reprezentuje 10 BBU/ml (Biomedica Borrelia Units) a je základem pro výpočet výsledků.

$$\frac{\text{OD of the sample}}{\text{OD of the cut off control}} \times 10 = \text{BBU / ml}$$

8.1. Kvalitativní výpočet pro sérum a plasma

Positivní výsledek:	vzorky s hodnotou OD větší o 10% než hraniční $\geq 11 \text{ BBU/ml}$.
Neurčitý výsledek:	vzorky s OD mezi 9 BBU/ml – 11 BBU/ml (šedá zóna). U těchto nemocných se musí vyšetřit vzorek z nového odběru.
Negativní výsledek:	vzorky s hodnotou OD menší o 10% než hraniční $\leq 9 \text{ BBU/ml}$.

8.2. Kvantitativní výpočet pro sérum a plasma

Výpočet BBU/ml je stejný jako v odstavci 8.1.

Výsledky testu jsou lineární v rozmezí 5 BBU/ml – 30 BBU/ml, výsledky mimo tento rozsah jsou semikvantitativní.

Případně vzorky s výsledky >30 BBU/ml mohou být ředěny a opakovaně testovány. Získané výsledky musí být násobeny

příslušným faktorem ředění na výslednou koncentraci.

Slabě pozitivní	hodnoty od 11 BBU/ml do 20 BBU/ml.
Pozitivní	hodnoty od 21 BBU/ml do 30 BBU/ml.
Vysoko pozitivní	hodnoty vyšší než 30 BBU/ml.

8.3. Kvantitativní výpočet pro mozkomišní mok

Výpočet BBU/ml je stejný jako výpočet v odstavci 8.1.

Normální hodnota: bylo zjištěno, že průměrná hodnota z 30 vzorků mozkomišního moku je 0,9 BBU/ml.

Neuroborrelioza negativní.	vzorky s hodnotou \leq 5 BBU/ml.
Suspektní neuroborrelioza:	vzorky s hodnotou $>$ 5 BBU/ml.

9) CHARAKTERISTIKA TESTU

Platné (validní) výsledky:

blank	Hodnota OD musí být $< 0,250$
negativních kontrol	Hodnota OD musí být $< 0,200$ (odečtený blank)
hraniční musí být	Hodnota OD musí být nejméně dvojnásobek negativní kontroly (odečtený blank)
pozitivní kontroly	Hodnota OD musí být nejméně dvojnásobek hraniční kontroly (odečtený blank)

Zkřížená reaktivita:

	n	výsledek
Revmatoidní faktor	15	0
Syfilis pozitivita	7	0

Zkřížená reaktivita nebyla s těmito faktory pozorována, vzhledem k tomu, že tato souprava ELISA používá rekombinantní antigeny. Nicméně nelze zkříženou reaktivitu zcela vyloučit u vzorků od pacientů s autoimunním onemocněním.

Specifita & Citlivost:

	Sérum	CSF
Citlivost	100%	88%
Specifita	96%	88%

10) PŘESNOST

vnitřní	poz. (n=8)	vys. (poz n=8)	mezi testy	poz. (n=12)	vys. poz. (n=12)
Aritmetický průměr (BBU/ml)	29	43	Aritmetický průměr (BBU/ml)	29	46
SD (BBU/ml)	2	4	SD (BBU/ml)	2	3
CV (%)	7,6	9,1	CV (%)	6,8	6,6

SD – směrodatná odchylka; CV – variační koeficient

11) TECHNICKÉ POKYNY

- Nikdy nenahrazujte nebo nesmichávejte reagenciemi z jiných šarží nebo souprav.
- Při míchání reagencí nesmí dojít k tvorbě pěny.
- Nezaměňujte zátoky nebo uzávěry mezi reagenciemi a nepoužívejte je z jiných šarží nebo souprav.
- Nikdy nepoužívejte reagencie po jejich datu expirace. Nevystavujte reagencie působení přímého světla.
- Substrátový roztok vždy musí být bezbarvý.

12) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Všechny reagencie lidského původu v soupravě byly testovány soupravami 3. generace na přítomnost protilátek proti HIV a antigen, HCV a antigenu HBsAg a bylo zjištěno, že jsou negativní. Nicméně musí být s nimi zacházeno jako kdyby byly infekční. Kapalné reagencie obsahují $\leq 0,1\%$ Proclin 950 jako konzervant. Proclin 950 není toxicní v koncentracích, ve kterých je obsažen v reagencích této soupravy. Může vyvolat alergické reakce kůže, nesmí přijít do styku s kůží nebo zrakem.

- Nepipetejte ústy.
- Nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte kosmetiku, když pracujete se soupravou.

- Vyvarujte se kontaktu reagencí s pokožkou, vždy používejte rukavice na jedno použití.
- Kyselina sírová vyvolává poleptání kůže, očí a sliznic. Pokud dojde k pořísnění touto reagencí, musí se ihned pořísněné místo opláchnout velkým množstvím vody, případně vyhledat lékařskou pomoc.

13) LITERATURA

Viz. 13) *LITERATURE* v anglické části tohoto příbalového letáku.

1) ÚVOD

Lymkská borelióza je bakteriálna infekcia spôsobená spirochetou *Borrelia Burgdorferi*, *Afzelii* alebo *Garinii* a je charakterizovaná viacerými klinickými symptómmi. Infekcia boreliou sa môže deliť do troch štadií:

Štadium 1, skôr dermatitis, Klinicky: erytma migrans.

Štadium 2, skôr diseminovaná infekcia, Klinicky: lymfocytárna meningoradiculítida (Bannwarthov syndróm), neuroborelióza.

Štadium 3, pozdná diseminovaná infekcia, Klinicky: chronická progresívna encefalomyelítida, acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), chronická artritída.

Pre zlepšenie diagnostickej špecifity sú mikrostripy od firmy Biomedica potiahnuté nasledujúcimi rekombinantými antigenmi:

- p21 = OspC (outer surface protein C – vonkajší povrchový proteín C): *B. burgdorferi* sensu stricto (B31), *B. garinii* (20047)
- p18: *B. afzelii* (pKo)
- p100: *B. afzelii* (pKo)
- VlsE: protein fúzie rôznych génových druhov borreliie

2) ZLOŽENIE SÚPRAVY

Všetky reagencie okrem premývacieho roztoku sa používajú neriedené. Skladujú sa pri 2-8°C.

OZNAČENIE	KOMPONENTY SÚPRAVY	MNOŽSTVO
PLATE	Mikrostripy, odlomiteľné, farebne označené, potiahnuté rekombinantrným antigenom	12 x 8 testov
STD	Štandardy: pozitívny (pos), hraničný (cut-off), negatívny (neg), pripravené na použitie	každý 1 x 1,5 ml
CONJ	Konjugát: králičí antihuamý IgG-HRPO, pripravený na použitie	1 x 14 ml
DIL	Roztok na riedenie vzoriek, obsahujúci žlté farbivo, pripravený na použitie	1 x 105 ml
SUB	Substrát: TMB substrátový roztok, pripravený na použitie	1 x 13 ml
WASHBUF	Premývací roztok: 20x koncentrovaný	1 x 50 ml
STOP	Stop roztok: kyselina sírová, pripravená na použitie	1 x 10 ml

3) MATERIÁLY DODÁVANÉ V SÚPRAVE

- 2 samolepiace fólie na prelepenie platničiek
- kontrolný list kvality
- pomocná tabuľka k platničke
- návod na použitie

4) ZARIADENIA NA STANOVENIE TESTU – NEDODÁVANÉ

- mikropipety kalibrované na dávkovanie 10 – 1000 µl a vymeniteľné špičky
- multikanálová pipeta
- ELISA spektrofotometer s Inovou dĺžkou 450 nm (prípadne od 450 do 630 nm)
- milimetrový papier alebo počítačový program na výpočet výsledkov
- odporúčame premývačku platničiek

5) PRÍPRAVA REAGENCIÍ A VZORIEK

Príprava vzorky:

Vzorka môže byť sérum alebo plazma (EDTA, citrát, heparín, CPD), ktoré sa musia čo najskôr po odbere vzoriek krví oddeliť od kvnej zrazeniny, aby sa zabránilo hemolýze. Môže sa použiť aj mozgovo miešny mok. Zabráňte mikrobiálnej kontaminácii vzoriek. Nerozpustné látky sa musia zo vzorky odstrániť pred inkubáciou. Použitie tepelne inaktivovaných, ikterických, hemolytických, lipemických alebo zakalených vzoriek sa neodporúča.

Upozornenie: Ak sa testy nevykonajú ihneď, vzorky sa môžu skladovať až 2 týždne pri teplote + 4 ° C. Predĺžené skladovanie vzoriek je možné pri teplote -25 ° C alebo nižšej. Opakované zmrazenie a rozmrzovanie vzoriek sa neodporúča kvôli riziku nepresných výsledkov. Vyvarujte sa viac ako troch cyklov zmrzovania a rozmrzovania.

Riedenie vzoriek: Nariedte ľudské sérum alebo plazmu 1 + 100 s riediacim roztokom pre vzorky (t.j. 10 µl vzorky + 1 ml riediaceho roztoku), dobre premiešajte.

Nariedte likvor v pomere 1:3 (1 + 2) s riediacim roztokom pre vzorky (t.j. 100 µl vzorky + 200 µl riediaceho roztoku), dobre premiešajte.

Vzorky s výsledkami >30 BBU/ml môžu byť nariedené roztokom na riedenie vzoriek a znova pretestované. Namerané výsledky musia byť vynásobené príslušným riediacim faktorom pre získanie finálnej koncentrácie.

Konjugát, pripravený na použitie, spotrebujte do 2 týždňov po otvorení. Pre dlhodobé uskladnenie nepoužíť konjugát rozdeľte na alikvotné časti a uskladnite zmrazený pri -25°C až do doby exspirácie.

Príprava WASHBUF (premývacieho roztoku): Nariedte 20x koncentrovaný premývací roztok destilovanou vodou do 1000 ml (50 ml koncentrátu + 950 ml destilovanej vody). Dobre premiešajte. Kryštály, ktoré sa môžu objaví, sa rozpustia pri laboratórnej teplote. Nenariedený premývací roztok je stabilný pri teplote 2-8°C až do doby expirácie vyznačenej na etikete. Nariedený premývací roztok je stabilný pri teplote 2-8°C jeden mesiac.

STD: štandardy (negatívne, cut-off, pozitívne) sú pripravené na použitie a NESMÚ sa riediť.

6) PRINCÍP STANOVENIA

Vid' 6) PRINCIPLE OF THE ASSAY v anglickej časti textu na obale.

7) POSTUP STANOVENIA

Pred stanovením sa všetky reagencie a vzorky temperujú na laboratórnu teplotu (18-26°C).

Na priloženej pomocnej tabuľke platničky označte miesta pre BLANK/STD/SAMPLE (slepý pokus, štandard a vzorky).

Vyberte potrebný počet mikrostripov z lobilu. Označte minimálne jednu jamku ako slepý pokus. Nepoužité stripy skladujte spolu s desikantom pri 2-8°C v uzavretom alobalovom obale. Mikrostripy sú stabilné do doby exspirácie vyznačenej na etikete.

1. Napipetujte 100 µl STD/SAMPLE (štandardov a nariedených vzoriek) do príslušných jamek, okrem slepého pokusu.
2. **Stripy zalepte samolepiacou fóliou a nechajte inkubovať 1 hodinu pri teplote 37°C v inkubátore.**
3. Premývačkou odsaite obsah jamek a jamky premyte najmenej 4x s 250 µl zriedeneho WASHBUF (premývacieho roztoku). Po skončení premývania sa stripy osušia odklepaním zvyšného premývacieho roztoku na filtračný papier alebo buničitú vatu.
4. Napipetujte 100 µl CONJ (konjugát antihumány IgG-HRPO) do všetkých jamek.
5. **Stripy zalepte samolepiacou fóliou a nechajte inkubovať 30 minút pri laboratórnej teplote (18-26°C).**
6. Premývačkou odsaite obsah jamek a jamky premyte najmenej 4x s 250 µl zriedeneho WASHBUF (premývacieho roztoku). Po skončení premývania sa stripy osušia odklepaním zvyšného premývacieho roztoku na filtračný papier alebo buničitú vatu.
7. Napipetujte 100 µl SUB (TMB substrátu) do všetkých jamek.
8. **Nechajte inkubovať 15 min pri laboratórnej teplote (18-26°C) v tme.**
9. Napipetujte 50 µl STOP (stop roztoku) do všetkých jamek.
10. Ihneď zmerajte absorbanciu pomocou spektrotometra pri 450 nm s použitím referenčného filtra 630 nm, ak je referenčný filter k dispozícii.

Na stanovenie je s malými modifikáciami možné použiť automatický systém. Pre dopĺňajúce informácie, prosím, kontaktujte Vášho obchodného zástupcu.

8) VÝPOČET VÝSLEDKOV

Odpocítajte hodnotu absorbancie (OD) slepého pokusu od hodnoty absorbancií vzoriek a štandardov.

Vypočítajte priemernú hodnotu absorbancií všetkých vzoriek a štandardov.

Hodnota absorbancie hranicného (cut-off) štandardu predstavuje 10 BBU/ml (Biomedica Borrelia Units). Táto hodnota je základom pre výpočet výsledkov.

$$\frac{\text{OD of the sample}}{\text{OD of the cut off control}} \times 10 = \text{BBU / ml}$$

8.1. Kvalitatívny výpočet pre sérum / plazmu

Pozitívny výsledok	Vzorky s OD väčšou ako hranicný štandard +10% ($\geq 11 \text{ BBU/ml}$)
Hranicný výsledok	Vzorky medzi 9 – 11 BBU/ml. Títo pacienti by mali byť znova vyšetrení s novou vzorkou.
Negatívny výsledok	Vzorky s OD menšou ako hranicný štandard -10% ($\leq 9 \text{ BBU/ml}$)

8.2. Kvantitatívny výpočet pre sérum / plazmu

Výpočet jednotiek BBU/ml je rovnaký ako pri kvalitatívnom výpočte, kapitola 8.1.

Výsledky sú lineárne v rozmedzí 5 - 30 BBU/ml. Hodnoty mimo tohto rozpätia sú semi-kvantitatívne.

Alternatívne, vzorky s výsledkami >30 BBU/ml môžu byť nariadené roztokom na riedenie vzoriek a znova pretestované. Namerané výsledky musia byť vynásobené príslušným riediacim faktorom pre získanie finálnej koncentrácie.

Slabo pozitívne	Vzorky medzi 11 a 20 BBU/ml
Silne pozitívne	Vzorky medzi 21 a 30 BBU/ml
Veľmi silne pozitívne	Vzorky nad 30 BBU/ml

8.3. Kvalitatívny výpočet pre likvor

Výpočet jednotiek BBU/ml je rovnaký ako pri kvalitatívnom výpočte, kapitola 8.1.

Referenčné hodnoty likvoru: Priemerná hodnota z 30 vzoriek likvoru bola 0,9 BBU/ml.

Neuroborelióza - negatívna	Vzorky s hodnotami ≤ 5 BBU/ml
Podozrenie na neuroboreliózu	Vzorky s hodnotami > 5 BBU/ml

9) ŠPECIFICKÁ CHARAKTERISTIKA TESTOV

Validácia výsledkov:

Slepý pokus	Hodnoty OD musia byť $\leq 0,250$
Negatívny štandard	Hodnoty OD musia byť $\leq 0,200$ (odpočítaná hodnota slepého pokusu)
Hraničný štandard	Hodnoty OD musia byť minimálne dvojnásobkom hodnoty negatívneho štandardu (odpočítaná hodnota slepého pokusu)
Pozitívny štandard	Hodnoty OD musia byť minimálne dvojnásobkom hodnoty hraničného štandardu (odpočítaná hodnota slepého pokusu)

Skrižené reakcie

	n	skrižená reakcia
reumatoiodný faktor - pozitívny	15	0
syfilis - pozitívny	7	0

Táto ELISA metodika používa rekombinantré antigény. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť krížové reakcie na autoimunopozitívne vzorky.

Senzitivita: & špecifickosť:

	sérum	CSF
senzitivita	100%	88%
špecifickosť	96%	88%

10) PRESNOSŤ

V rámci testu	pozitívne (n = 8)	vysoko pozitívne (n = 8)	Medzi testami	pozitívne (n = 12)	vysoko pozitívne (n = 12)
Priemer (BBU/ml)	29	43	Priemer (BBU/ml)	29	46
SD (BBU/ml)	2	4	SD (BBU/ml)	2	3
CV (%)	7,6	9,1	CV (%)	6,8	6,6

11) TECHNICKÉ POKYNY

- Nevymieňajte jednotlivé komponenty súpravy medzi rôznymi šaržami súprav.
- Zabráňte tvorbe peny pri miešaní reagencií.
- Nezamieňajte viečka a uzávery na rôznych fľaštičkách alebo medzi fľaštičkami z rôznych šarží.
- Nepoužívajte jednotlivé komponenty súpravy po uplynutí doby expirácie. Chráňte reagencie pred svetlom.
- Roztok substrátu má zostať bezfarebný až do doby, kým nie je napipetovaný na plátničku.

12) BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Všetky zložky súpravy ľudského pôvodu boli testované treťou generáciou testov proti HIV-Ab, HCV-Ab a HBsAg a sú negatívne. Napriek tomu je potrebné s nimi zaobchádzať podľa pokynov na manipuláciu s infekčným materiálom.

Všetky kvapalné reagencie obsahujú ≤0.1% Proclinu 950 ako konzervačného prípravku. Štandardy boli stanovené na bunkových kultúrach a nie sú infekčné. Napriek tomu treba s nimi zaobchádzať podľa pokynov na manipuláciu s infekčným materiálom. Zabráňte jeho kontaktu s okožkou a ukóznu sliznicou.

- Nepipetujte ústami.
- V riestoroch kde sa používajú reagencie nejedzte, nepite, nefajčíte a nepoužívajte kozmetické prípravky.
- Vylúčte akýkolvek kontakt s reagenciemi používaním rukavic.
- Kyselina sírová dráždi oči a pokožku. V rípade kontaktu s yselinou, zasiahnuté miesto ihneď umyte tečúcou vodou. Zabráňte kontaktu kyseliny s okožkou a sliznicou – môžu vzniknúť podráždeniny. V rípade kontaktu umyte tečúcou vodou!

13) LITERATÚRA

Viď 13) *LITERATURE* v anglickej časti textu na obale.

1) WSTĘP

Borelioza z Lyme jest bakteryjną infekcją wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi, afzelii lub garinii. Choroba charakteryzuje się wieloma różnymi objawami. Występowanie, których można podzielić na 3 etapy:

Etap 1, wczesne zapalenie skóry, objawy kliniczne: rumień wędrujący.

Etap 2, wczesna rozsiana infekcja, objawy kliniczne: limfocytarne zapalenie opon i korzeni nerwowych (zespół Banwartha), neuroborelioza.

Etap 3, późna rozsiana infekcja, objawy kliniczne: przewlekłe, postępujące zapalenie mózgu i rdzenia, zanikowe zapalenie skóry, przewlekłe zapalenie stawów.

Dla poprawy specyficzności diagnostycznej dolki mikroplptyki opłaszczone następującymi antygenami rekombinowanymi:

- p21 = OspC (outer surface protein C – zewnętrzne powierzchniowe białko C): B. burgdorferi sensu stricto (B31), B. garinii (20047)
- p18: B. afzelii (pKo)
- p100: B. afzelii (pKo)
- VlsE: białko fuzyjne różnych genogatunków Borrelia

2) SKŁAD ZESTAWU

Wszystkie odczynniki z wyjątkiem buforu są gotowe do użycia. Przechowywać w 2-8°C.

NAZWA	SKŁADNIKI ZESTAWU	ILOŚĆ
PLATE	Łamane paski, oznaczone kolorem, opłaszczone rekombinowanymi antygenami	12 x 8 dolków
STD	Standardy: dodatni (pos), cut-off (c.o.), ujemny (neg), gotowe do użycia	Każdy po 1 x 1,5 ml
CONJ	Koniugat: królicze anty-ludzkie IgG-HRPO, gotowy do użycia	1 x 14 ml
DIL	Rozcieńczalnik do próbek z żółtym barwnikiem, gotowy do użycia	1 x 105 ml
SUB	Substrat: roztwór TMB, gotowy do użycia	1 x 13 ml
WASHBUF	Bufor pluczający: stężony 20x	1 x 50 ml
STOP	Roztwór hamujący: kwas siarkowy, gotowy do użycia	1 x 10 ml

3) DODATKOWE MATERIAŁY DOSTARCZONE W ZESTAWIE

- 2 folie samoprzylepne
- Protokół kontroli jakości
- Protokół roboczy
- Instrukcja wykonania

4) PRZYRZĄDY DO WYKONANIA TESTU – NIE DOSTARCZONE

- Mikropipety o pojemnościach 10 - 1000 µl i jednorazowe końcówki
- Pipeta wielokanałowa
- Czytnik mikroplptyk Elisa z filtrem 450 nm (ewentualnie od 450 nm do 630 nm), papier milimetrowy lub program do obliczania wyników
- Zaleca się użycie automatycznej pluczki do mikroplptyk

5) PRZYGOTOWANIE ODCZYNNIKÓW I PRÓBEK

Przygotowanie próbki:

Jako próbki można użyć surowicy lub osocza (EDTA, cytrynianowego, heparynowego, CPD), które muszą zostać oddzielone od skrzepu naj szybciej jak jest to możliwe po pobraniu krwi, aby zapobiec hemolizie. Można również użyć płynu mózgowo-rdzeniowego. Nie dopuścić do mikrobiologicznego zanieczyszczenia próbki. Substancje nierozpuszczalne muszą zostać usunięte z próbki przed inkubacją. Nie zaleca się używania próbek inaktywowanych cieplnie, ikterycznych, hemolitycznych, lipemicznych lub mlejnych.

Uwaga: Jeśli badania nie będą prowadzane od razu, próbki mogą być przechowywane w temp. +4°C do dwóch tygodni. Dłuższe przechowywanie próbek jest możliwe w temp. -25°C lub niższej. Nie zaleca się powtórnego zamrażania/rozmarzania próbek z uwagi na ryzyko uzyskania niedokładnych wyników. Unikać przeprowadzania więcej niż 3 cykli zamrażania/rozmrzienia.

Rozcieńczanie próbek: Surowicę lub osocze rozcieńczać rozcieńczalnikiem do próbek 1:101 (1 + 100) (np. 10 µl próbki + 1 ml rozcieńczalnika), dokładnie wymieszać.

Plyn mózgowo-rdzeniowy rozcieńczać w stosunku 1:3 (1 + 2) rozcieńczalnikiem do próbek (np. 100 µl próbki + 200 µl rozcieńczalnika), dokładnie wymieszać.

Dla próbek o wartościach powyżej 30 BBU/ml można wykonać dodatkowe rozcieńczenie (przy pomocy rozcieńczalnika do próbek) i ponownie przeprowadzić analizę. Uzyskany w ten sposób wynik należy pomnożyć zgodnie ze stopniem dodatkowego rozcieńczenia.

Koniugat: Gotowy do użycia koniugat powinien zostać zużyty w trakcie 2 tygodni po otwarciu.

Dla dłuższego przechowywania do daty ważności nie zużyty koniugat rozpipetować na porcję i zamrozić w -25°C.

Przygotowanie buforu pluczacego: Dopełnić skoncentrowany (20x) bufor wodą destylowaną do 1000 ml (50 ml buforu + 950 ml wody destylowanej). Dokładnie wymieszać. Jeżeli w koncentracie wytrąca się kryształy, powinny rozpuścić się w temperaturze pokojowej. Nierozcieńczony bufor pluczający jest stabilny w temp. 2-8°C do daty podanej na etykiecie. Po rozcieńczeniu bufor stabilny jest przez okres jednego miesiąca w temp. 2-8°C.

STD: standardy (negatywny, cut-off, pozytywny) są gotowe do użycia i NIE WOLNO ich rozcieńczać.

6) ZASADA OZNACZANIA

Zobacz 6) PRINCIPLE OF THE ASSAY - rysunek w angielskiej części instrukcji.

7) PROTOKÓŁ TESTU

Wszystkie odczynniki i próbki przed wykonaniem testu przenieść do temperatury pokojowej (18-26°C).

Zaznaczyć pozycje dla ślepej (blank) / standardów / próbek na protokole roboczym.

Wyjąć z aluminiowej torebki odpowiednią ilość dółków. Przygotować przynajmniej jeden dolek na blank. Nie używane dółki schować do torebki ze środkiem osuszającym i umieścić w temperaturze 2-8°C. Dółki są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie.

1. Dodać 100 µl standardów i rozcieńczonych próbek do odpowiednich dółków, oprócz blanku.
2. **Zakleić dółki folią i inkubować 1 godzinę w 37°C.**
3. Odessać płyn z dółków i wypłukać je 4x 250 µl rozcieńczonym buforem plującym. Po plukaniu usunąć resztki buforu poprzez odwrócenie na bibule i ostukanie dółków.
4. Dodać 100 µl koniugatu (anti-ludzkie IgG-HRPO) do wszystkich dółków.
5. **Zakleić dółki folią i inkubować 30 minut w temperaturze pokojowej (18-26°C).**
6. Odessać płyn z dółków i wypłukać je 4x 250 µl rozcieńczonym buforem plującym. Po plukaniu usunąć resztki buforu poprzez odwrócenie na bibule i ostukanie dółków.
7. Dodać 100 µl substratu (TMB) do wszystkich dółków.
8. **Inkubować 15 minut w temperaturze pokojowej (18-26°C), w ciemności.**
9. Dodać 50 µl roztworu hamującego do wszystkich dółków.
10. Natychmiast odczytać absorbancję przy długości fali 450 nm z filtrem referencyjnym 630 nm (jeżeli jest dostępny).

Możliwe jest użycie systemu automatycznego, lecz może wymagać to pewnych modyfikacji. W razie potrzeby prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

8) OBLCZANIE WYNIKÓW

Odjąć absorbancję blanku od absorbancji próbek i standardów.

Obliczyć średnie absorbancje wszystkich próbek i standardów.

Absorbancja standardu cutoff odzwierciedla wartość 10 BBU/ml (Biomedica Borrelia Units). Jest to podstawa obliczania wyników.

$$\frac{\text{Ø OD of the sample}}{\text{Ø OD of the cut off control}} \times 10 = \text{BBU / ml}$$

8.1. Kalkulacja jakościowa dla surowicy/osocza

Wynik dodatni	próbki o ABS wyższej od cut-off +10% ($\geq 11 \text{ BBU/ml}$).
---------------	--

Wynik wątplawy	próbki pomiędzy 9 - 11 BBU/ml. Zaleca się powtórzenie z nowo pobraną próbką.
----------------	--

Wynik ujemny	próbki o ABS niższej od cut-off -10% ($\leq 9 \text{ BBU/ml}$).
--------------	---

8.2. Kalkulacja ilościowa dla surowicy/osocza

Kalkulacja BBU/ml jest identyczna jak kalkulacja jakościowa, punkt 8.1.

Test zachowuje liniowość w zakresie 5 - 30 BBU/ml. Wartości poza tym zakresem są półilościowe.

Ewentualnie, próbki z wynikiem >30BBU/ml mogą być dodatkowo rozcieńczone (przy pomocy rozcieńczalnika do próbek) i

ponownie oznaczone. Uzyskany wniki koniecznie należy pomnożyć przez stopień dodatkowego rozcieńczenia.

Nisko dodatni	Próbki pomiędzy 11 i 20 BBU/ml.
Wysоко dodatni	Próbki pomiędzy 21 i 30 BBU/ml.
Bardzo wysoko dodatni	Próbki powyżej 30 BBU/ml.

8.3. Kalkulacja jakościowa dla płynu mózgowo-rdzeniowego

Kalkulacja BBU/ml jest identyczna jak kalkulacja jakościowa, punkt 8.1.

Wartości normalne dla PMR: Średnia z 30 próbek PMR wynosi 0,9 BBU/ml.

Brak neuroboreliozy	Próbki o wartościach \leq 5 BBU/ml
Podejrzenie neuroboreliozy	Próbki o wartościach $>$ 5 BBU/ml

9) CHARAKTERYSTYKA TESTU

Kryteria ważności testu:

Blanku	ABS musi być \leq 0,250
Standard ujemny	ABS musi być \leq 0,200 (odjęta wartość próby ślepej)
Standard cut-off	ABS musi być przynajmniej dwa razy wyższa od ABS standardu ujemnego (odjęta wartość próby ślepej)
Standard dodatni	ABS musi być przynajmniej dwa razy wyższa od ABS standardu cut-off (odjęta wartość próby ślepej)

Reakcje krzyżowe

	n	Reakcje krzyżowe
Dodatnie w kierunku czynnika reumatoidalnego	15	0
Dodatnie w kierunku kity	7	0

Test ten jest oparty na rekombinowanych antygenach. Nie można jednak całkowicie wykluczyć reakcji krzyżowych z próbками dodatnimi w kierunku parametrów autoimmunologicznych.

Specyficzność & Czułość:

	Surowica	PMR/płyn mózgowo- rdzeniowy
Czułość	100%	88%
Specyficzność	96%	88%

10) PRECYZJA

Wewnętrznoznaczeniowa	Dodatnie n=8	Wysoko dodatnie n=8	Miedzyoznaczeniowa	Dodatnie n=12	Wysoko dodatnie n=12
Średnia (BBU/ml)	29	43	Średnia (BBU/ml)	29	46
SD (BBU/ml)	2	4	SD (BBU/ml)	2	3
CV (%)	7,6	9,1	CV (%)	6,8	6,6

11) WSKAŻÓWKI TECHNICZNE

- Nie mieszać i nie zastępować odczynników z zestawu odczynnikami z innych serii lub źródeł.
- W czasie mieszania odczynników unikać pienienia.
- Nie wymieniać korków i zakrętek od różnych odczynników. Nie używać odczynników z różnych serii.
- Nie używać odczynników po upływie daty ważności. Chronić odczynniki przed światłem słonecznym.
- Substrat powinien pozostać bezbarwny do momentu dodania do dółków.

12) UWAGI

Wszystkie składniki zestawu pochodzenia ludzkiego były testowane przy pomocy testów trzeciej generacji przeciwko anty-HIV I anty-HCV I HBsAg I zostały określone jako ujemne. Pomimo tego należy postępować z nimi jak z materiałem zakaźnym. Odczynniki płynne zawierają \leq 0,1 % roztwór Prokliny 950 jako środek konserwujący. Proclin 950 nie jest toksyczny w stężeniach użytych w tym zestawie. Może wywoływać reakcję alergiczną, unikać kontaktu ze skórą lub oczami.

- Nie pipetować ustami.
- Nie jeść, nie pić, nie palić i nie używać kosmetyków, w pomieszczeniach gdzie pracuje się z zestawem.
- Unikać jakiegokolwiek kontaktu z odczynnikami poprzez używanie rękawic.
- Kwas siarkowy podrażnia oczy i skórę. W przypadku kontaktu z kwasem, miejsce kontaktu natychmiast splukać bieżącą wodą. Unikać kontaktu kwasu ze skórą i błonami śluzowymi. Możliwe wystąpienie podrażnień. W przypadku kontaktu splukać bieżącą wodą!

13) LITERATURA

Zobacz 13) *LITERATURE* w angielskiej części ulotki.

1) BEVEZETÉS

A Lyme borreliosis a spirochaete Borrelia Burgdorferi, B.afzelii vagy B.garinii, által okozott bakteriális fertőzés, mely különböző klinikai szimptómákkal jellemzhető. 3 stádium van:

1. stadium: korai dermatitis, klinikai elnevezése: erythema migrans.
2. stadium: korai szóródás, klinikai elnevezése: lymphocita meningoradiculitis (Bannwarth szindróma), neuroborreliosis.
3. stádium, késői szóródás, klinikai elnevezése: krónikus progresszív encephalomyelitis, acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), krónikus arthritis.

A diagnosztikai specificitás javítása érdekében a Biomedica vizsgálati csíkokon lévő mikrolyukakat a következő rekombináns antigénekkel vonták be:

- p21 = OspC (outer surface protein C – külső felszíni protein C): B. burgdorferi sensu stricto (B31), B. garinii (20047)
- p18: B. afzelii (pKo)
- p100: B. afzelii (pKo)
- VlsE (változékony lipoprotein): különböző Borrelia genospeciesek

2) A KIT TARTALMA

A mosó puffer kivéve az összes reagens használatra kész. A reagenseket 2-8°C-on tároljuk.

TARTALOM	A KIT KOMPONENTEI	MENNYISÉG
PLATE	Mikrolyukakat tartalmazó csíkok, törhetők, színkódoltak, rekombináns antigénnel bevonva	12 x 8 csík
STD	Standardok: pozitív (pos), cut-off (c.o.), negatív (neg), használatra kész	egyenként 1 x 1.5 ml
CONJ	Konjugátum: nyúl anti-humán IgG-HRPO, használatra kész	1 x 14 ml
DIL	Mintahigító zöld színezékkel, használatra kész	1 x 105 ml
SUB	Szubsztrát: TMB szubsztrát oldat, használatra kész	1 x 13 ml
WASHBUF	Mosó puffer: 20x koncentrátumú	1 x 50 ml
STOP	Stoppoló oldat: kénsav, használatra kész	1 x 10 ml

3) A KITHEZ MELLÉKELT EGYÉB ANYAGOK

- 2 öntapadó műanyag film
- Quality kontroll lap
- Protokoll lap
- Használati utasítás

4) SZÜKSÉGES, DE NEM SZÁLLÍTOTT FELSZERELÉSEK

- Precíziós pipetták 10-1000 µl –es eldobható pipettahegyekre kalibrálva
- Többcsatornás pipetta
- ELISA leolvasó az abszorbancia 450 nm-en (ill. 450 nm - 630 nm közötti értéken)
- Történő leolvasására. Milliméter papír vagy software az eredmények kiszámítására
- A mosáshoz lemezmosó javasolt

5) A REAGENSEK ÉS A MINTÁK ELŐKÉSZÍTÉSE

Mintaelőkészítés:

A minta lehet szérum vagy plazma (EDTA, citrát, heparin, CPD), amelyet vérvétel után a lehető leghamarabb el kell választani az alvadéktól a hemolízis elkerülése érdekében. CSF minta szintén használható. Kerülje a minták mikrobiális szennyeződését. Az oldhatatlan anyagokat az inkubálás előtt el kell távolítani a mintából. A hő-inaktivált, ikerikus, hemolitikus, lipémiás vagy zavaros minták alkalmazása nem ajánlott.

Figyelmezettség: Ha a vizsgálatokat nem végzik azonnal, a mintákat legfeljebb 2 hétag tárolhatjuk 2-8°C-on. A minták hosszantartó tárolása -25°C-on vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten megengedett. A minták ismételt fagyásztása és felolvasztása nem ajánlott a pontatlan eredmények kockázata miatt. Hárommá több alkalommal nem szabad a mintát fagyásztani-felengedni.

Mintahígítás: Hígitsuk fel a humánszérumot vagy plazmát 1 + 100 arányban mintahígítóval (pl. 10 µl minta + 1 ml mintahígító), jól keverjük meg. Hígitsuk fel a cerebrospinalis folyadékot 1:3 arányban (1 + 2) mintahígítóval (pl. 100 µl minta + 200 µl mintahígító), jól keverjük meg.

Ha a minta koncentrációja >30 BBU/ml, akkor a mintahígítóval történő további hígíthatás után a vizsgálat újra elvégezhető. A végső koncentráció kiszámításához, a kapott értéket szorozni kell a megfelelő hígítási faktorral.

Konjugátum: A használatra kész konjugátumot a kinyitása után 2 héten belül fel kell használni. A fel nem használt konjugátumot adagoljuk ki, majd fagyasszuk le a lejáratú idő tartamáig -25°C-ra.

A mosó puffer előkészítése: Hígitsuk fel a 20-szoros koncentrátumú mosó pufferet desztillált vízzel 1000 ml-re (50 ml koncentrátum + 950 ml desztillált víz). Jól keverjük meg. Az esetleg megijelő kristályszemcsék szabahőmérsékleten feloldódnak. A hígítatlan WASHBUF mosópuffer 2-8°C fokon tárolva stabil a címkén jelzett lejáratú ideig. A kihígított mosópuffer 2-8°C fokon tárolva 1 hónapig stabil.

STD: A standardok (negatív, cut-off, pozitív) használatra készek, nem kell higítani.

6) AZ ASSAY MŰKÖDÉSI ELVE

Lásd: Angol nyelvű használati utasítás 6. rész) PRINCIPLE OF THE ASSAY.

7) ASSAY PROTOKOLL

Használat előtt az összes reagensnek és mintának szabahőmérsékletűnek kell lennie (18-26°C).

Jelöljük be a protokoll lapon a vak, a standard és a minta elhelyezkedését.

Vegyük ki a mikrotiter csíkokat az alufólia zacskóból, legalább egy lyukat hagyunk a vak számára. A fel nem használt csíkokat deszíkkánossal tegyük vissza az alufólia zacskóba és tartsuk 2-8°C-on. A csíkok a címkén feltüntetett lejáratú időn belül stabilak maradnak.

1. Adjunk 100 µl standardot/hígított mintát a megfelelő lyukakba a vaknak kijelölt lyuk kivételével.
2. **Fedjük be a csíkokat a műanyag filmborítóval és inkubáljuk 1 órán át 37°C-on inkubátorban.**
3. Pipettázzunk és mossuk a lyukakat 4x legalább 250 µl hígított mosó pufferrel, majd az utolsó mosás után a lemez papírtörülköző feletti ütögetésével távolítsuk el a mosó puffer maradékát.
4. Adjunk 100 µl konjugátumot (anti-humán IgG-HRPO) mindegyik lyukba.
5. **Fedjük be a csíkokat a műanyag filmborítóval és inkubáljuk 30 percig szabahőmérsékleten (18-26°C)**
6. Pipettázzunk és mossuk a lyukakat 4x legalább 250 µl hígított mosó pufferrel, majd az utolsó mosás után a lemez papírtörülköző feletti ütögetésével távolítsuk el a mosó puffer maradékát.
7. Adjunk 100 µl szubsztrátot (TMB) mindegyik lyukba.
8. **Inkubáljuk 15 percig szabahőmérsékleten (18-26°C), sötétben.**
9. Adjunk 50 µl stoppoló oldatot mindegyik lyukba.
10. Azonnal mérjük meg az abszorbanciát 450 nm-en, ha lehetséges, 630 nm-es referenciaival.

Automata rendszer használata lehetséges, de van, amikor ehhez módosítások szükségesek. Amennyiben segítségre van szüksége, forduljon a cég képviselőjéhez.

8) AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA

A vak OD értékét vonjuk le a minták és a standardok OD értékéből.

Számoljuk ki az összes minta és standard átlag OD értékét.

A cutoff standard OD értéke 10 BBU/ml -nek felel meg (BBU=Biomedica Borrelia Egység). Ez az eredmények kiszámításának az alapja.

$$\frac{\text{Ø OD of the sample}}{\text{Ø OD of the cut off control}} \times 10 = \text{BBU / ml}$$

8.1. A szérumok/plazmák qualitatív kiértékelése

Pozitív eredmény	A cutoff érték +10% (≥ 11 BBU/ml) fölötti OD értékű minták esetén.
Határérték	9 - 11 BBU/ml értékek közötti minták. Ezeket a betegeket új mintával ismét tesztelni kell.
Negatív eredmény	A cutoff érték -10% (≤ 9 BBU/ml) alatti OD értékű minták esetén.

8.2. A szérumok/plazmák kvantitatív kiértékelése

BBU/ml érték kiszámítása azonos a 8.1-es fejezetben leírt kvalitatív kiértékeléssel.

A teszt 5 - 30 BBU/ml érték között lineáris. Az ezen a tartományon kívül eső értékek semi-kvantitatívak.

Alternatív módon, ha a minta koncentrációja > 30 BBU/ml, akkor a mintahígítóval történő további hígítatás után a vizsgálat újra elvégezhető. A végső koncentráció kiszámításához, a kapott értéket szorozni kell a megfelelő hígítási faktorral.

Gyenge pozitív	11 és 20 BBU/ml között értékelt minták
Erősen pozitív	21 és 30 BBU/ml közötti értékelt minták
Nagyon erősen pozitív	30 BBU/ml fölött értékelt minták

8.3. A cerebrospinalis folyadék kvalitatív kiértékelése

BBU/ml érték kiszámítása azonos a 8.1-es fejezetben leírt kvalitatív kiértékeléssel.

A CSF normál értékei: 30 CSF minta átlagértéke 0,9 BBU / ml.

Neuroborreliosis negatív	A minták értéke \leq 5 BBU / ml
Neuroborreliosis gyanús	A minták értéke $>$ 5 BBU / ml

9) AZ ASSAY JELLEMZŐI

Valid értékek:

Vak	Az OD értéknek \leq 0,250 kell lennie
Negatív standard	Az OD értéknek \leq 0,200 kell lennie (a vak érték levonva)
Cutoff standard	Az OD értéknek a negatív standardnál legalább kétszer magasabbnak kell lenni (a vak érték levonva).
Pozitív standard	Az OD értéknek a cutoff standard OD értékénél kétszer magasabbnak kell lennie (a vak érték levonva).

Keresztreakciók

	szám	Keresztreakciót képező
reumafaktor-positív	15	1
syphilis-positív	7	0

Ez az ELISA kit rekombináns antigéneket használ fel. Ugyanakkor az autoimmun-pozitív mintákkal történő keresztreakciókat nem lehet teljesen kizáráni.

Specificitás & Szenzitivitás:

	Szérum	CSF
Szenzitivitás	100%	88%
Specificitás	96%	88%

10) PRECÍZIÓ

Intra-Assay	poz. (n=8)	erősen poz. (n=8)	Inter-Assay	poz. (n=12)	erősen poz. (n=12)
Átlag (BBU/ml)	29	43	Átlag (BBU/ml)	29	46
SD (BBU/ml)	2	4	SD (BBU/ml)	2	3
CV (%)	7,6	9,1	CV (%)	6,8	6,6

11) TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK

- Ne keverjük vagy helyettesítésük a reagenseket másik LOT-tal rendelkező kitból vagy egyéb forrásból.
- A reagensek keverése közben kerüljük a habosodást.
- Ne keverjük össze a különböző reagensek zárókupakját, fedelét ill. ne használjuk különböző LOT-ok reagenseit.
- Ne használjuk a reagenseket a lejáratú időn túl. Övyük a reagenseket a napfénytől.
- A szubsztrát oldatnak színtelennek kell maradjnia, míg hozzá nem adják a lemezhez.

12) ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK

A teszt minden humán eredetű komponensét HIV, HCV és HBsAG antitesteket kímutató 3-ik generációs teszzel megvizsgálták, és negatívaknak találták. Ugyanakkor úgy kell ezeket kezelni ill. alkalmazni, mintha fertőzők lennének. A folyékony reagensek \leq 0,1% mennyiségen Proclin 950-at tartalmaznak tartósítószerekkel. A Proclin 950 a kithez használt koncentrációban nem toxikus. Allergiás bőrreakciókat okozhat, ne kerüljön a bőre vagy a szembe.

- Ne pipettázzunk szájjal.
- Ne együnk, igyunk, ne dohányozzunk és ne használunk kozmetikumokat azon a helyen, ahol dolgozunk.
- Kesztyű használatával kerüljük a reagensekkel való érintkezést.
- A kénsav irritálja a szemet és a bőrt. Öblítsük le vizsel, ha bőre, szeme került. Vigyázzunk, ne kerüljön bőrre vagy nyálkahártyára. Irritációk kialakulása lehetséges – Ha bőre vagy nyálkahártyára került, öblítsük le vizsel!

13) IRODALOM

Lásd: Angol nyelvű használati utasítás 13. rész) *LITERATURE*.

SYMBOLS



Expiry date / Verfallsdatum / Date de péremption / Data di scadenza / Fecha de caducidad / Data de validade / Uitsterste gebruiksdatum / Udløbsdato / Utgångsdatum / Termin Ważności / Lejárat idő / Doba exspirácie / Doba expirace



Consider instructions for use / Bitte Gebrauchsanweisung beachten / Consultez la notice d'utilisation / Consultare le istruzioni per l'uso / Consulte las instrucciones de utilización / Consulte as instruções de utilização / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Se brugsanvisningen / Läs anvisningarna före användning / Proszę przeczytać instrukcję wykonania / Vegyük figyelembe a használati utasításban foglaltakat / Postupujte podle pokynov na použitie / Postupujte dle návodu k použití



In vitro Diagnostic Medical Device (for in Vitro Diagnostic Use) / In vitro Diagnostikum (zur In-vitro-Diagnostik) / Dispositif médical de diagnostic in vitro (Pour usage diagnostique in vitro) / Dispositivo medico per diagnostica in vitro (per uso diagnostico in vitro) / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro (para uso diagnóstico in vitro) / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro (Para utilização do diagnóstico "in vitro") / Medisch hulpmiddel voor diagnostiek in vitro (Voor diagnostisch gebruik in vitro) / Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (Udelukkende til in vitro diagnostisk anvendelse) / Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik (För in vitro-diagnostiskt bruk) / Wyrob medyczny do Diagnostyki In Vitro / In vitro orvosdiagnosztikai termék / In vitro diagnostický zdravotnícky materiál (určené pre diagnostiku „in vitro“) / In vitro diagnostický zdravotnícky materiál (určeno pro diagnostiku „in vitro“)



Lot-Batch Number / Charge-Chargennummer / Lot-Code du lot / Lotto-Numero di lotto / Lote-Código de lote / Lote-Código do lote / Lot-Partijnummer / Lot-Batchkode / Lot-Satskod / Numer serii / Lot-Batch szám / Číslo šárže / Číslo šárže



Manufactured by / Hergestellt von / Fabriqué par / Prodotto da / Fabricado por / Fabricado por / Vervaardigd door / Fabrikation af / Tillverkad av / Wyprodukowane pr / Gyártotta / Vyrobené / Vyrobeno



Catalogue Number / Bestellnummer / Numéro de référence / Numero di riferimento / Número de referencia / Número de referência / Referentienummer / Referencenummer / Katalognummer / Numer katalogowy / Katalógusszám / Katalógové číslo / Katalogové číslo



Store at between / Lagerung bei zwischen / Conserver à entre / Conservare a tra / Conservar a temp. entre / Armazene a entre / Bewaar bij tussen / Opbevares mellem / Förvaras vid / Przechowywać w / Tároljuk között / Skladujte v rozsahu / Skladujte v rozmezí



Contains sufficient for x tests / Inhalt ausreichend für x Tests / Contient suffisant pour x tests / Contenu sufficiente per x test / Contiene suficiente para x pruebas / Contém suficiente para x testes / Bevat voldoende voor x bepalingen / Indeholder tilstrækkeligt til x prøver / Innehåller räcker till x analyser / Zawartość na x testów / Tartalma X teszt elvégzésére elegendő / Obsahuje materiál pre x testov / Obsahuje materiál pro x testů

BI-21032 ANTI BORRELIA IgG ASSAY PROTOCOL AND CHECKLIST

- Bring all reagents to room temperature (18-26°C).
 - Prepare reagents and samples as instructed.
 - Bring unused and prepared components to the storage temperature mentioned in the package insert.
 - Take microtiter strips out of the alu bag and mark positions on the protocol sheet.
-
- 1. Add 100 µl STD/SAMPLE (standard/ diluted sample) into each well, except blank.
 - 2. Cover tightly and incubate for 1 hour at 37°C.**
 - 3. Aspirate and wash wells with at least 250 µl WASHBUF (Wash buffer) four times. Remove remaining buffer by hitting plate against paper towel.
 - 4. Add 100 µl CONJ (Conjugate) into each well.
 - 5. Cover tightly and incubate for 30 minutes at room temperature.**
 - 6. Aspirate and wash wells with at least 250 µl WASHBUF (Wash buffer) four times. Remove remaining buffer by hitting plate against paper towel.
 - 7. Add 100 µl SUB (Substrate) into each well.
 - 8. Incubate for 15 minutes at room temperature (18-26°C), in the dark.**
 - 9. Add 50 µl STOP (Stop solution) into each well. Swirl gently.
 - 10. Read Optical Density at 450 nm with reference 630 nm, if available.